


Compat® Buddy

LOW-PROFILE GASTROSTOMY FEEDING TUBE EXTENSION SET

Návod k použití / Brugsanvisning / Gebrauchsanweisung / Oδηγίες χρήσης / Instructions for use / Instrucciones de uso / Käyttöohje / Mode d'emploi / Upute za uporabu / Használáti utasítás / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Brusansvisning / Instrukcja użycia / Instruções de uso / Návod na použitie / Navodila za uporabo / Bruksanvisning / Kullanim talimatları / 使用说明


Right Angle - Single ENFit® port 30CM|60CM

GLOBE REF 12475113 | 12474936

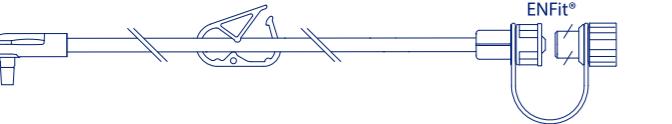


Straight - Single ENFit® port 30CM|60CM

GLOBE REF 12474949 | 12474937




Right Angle - Double ENFit® port 30CM|60CM

GLOBE REF 12475124 | 12474948


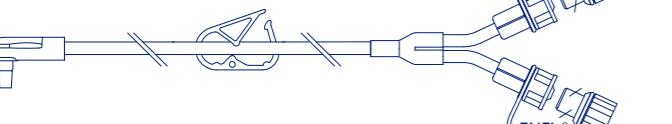


Right Angle - Double ENFit® port 5CM

GLOBE REF 12475125

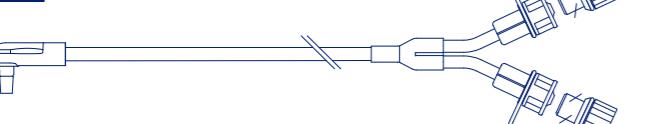

www.compat.com

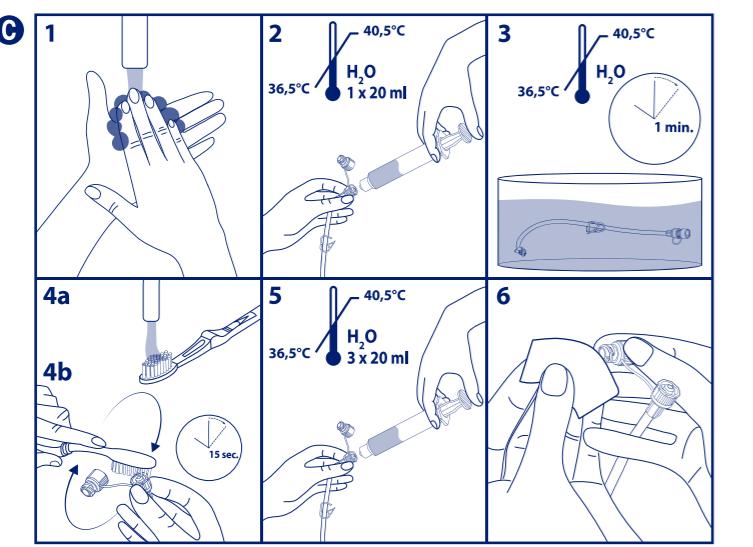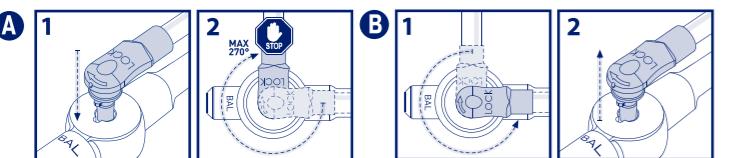

CE 0123 Cedic srl
Via Liberazione 63/9
IT-20068 Peschiera Borromeo (MI)

C01367-03
08NOV2020

- تأكيد دائمًا من أن الوراء الذي يتم تسليمه بواسطة مجموعة التغذية مناسب للجهاز المعمولية.
- إن الاستعمال: تم تصميم مجموعة مجموعات التغذيات من Compat® Buddy لجل تناول الطعام والسائل والدواء، من خلال التوصيل بـ الباب.

الباب.

- قم دائمًا بمراعاة المريض أثناء التقنية.

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

- لم يتم استخدام هذا الجهاز على النحو المنշود. يمكن تحث

شاف الكبار.

- لا يحتوي على القالات، بما في ذلك DEHP.

- غير منصنوع من الألكوكاين المطاط الطبيعي، لا ينبعض.

- .

- تحذيرات:

- للاستخدام المعياري فقط.

- غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.

- قم بإعداد مجموعة الإدارة المعمولية أو المحققة بمقدار

- ENFit®.

- صل مجموعة الإدار المعمولية أو المحققة بمقدار

- الخاص بمقدار التقنية.

- نظر كل الوراء من مجموعة التغذية بالسلامة/السائل

- والتتحقق من أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها مناسبة للجهاز المعمولية.

- قم بتغيير مجموعات التغذية بمقدار

- A.

- .

- .

- .

- .

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

- لم يتم استخدام هذا الجهاز على النحو المنشود. يمكن تحث

شاف الكبار.

- لا يحتوي على القالات، بما في ذلك DEHP.

- غير منصنوع من الألكوكاين المطاط الطبيعي، لا ينبعض.

- .

- تحذيرات:

- للاستخدام المعياري فقط.

- غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.

- قم بإعداد مجموعة الإدارة المعمولية أو المحققة بمقدار

- ENFit®.

- صل مجموعة الإدار المعمولية أو المحققة بمقدار

- الخاص بمقدار التقنية.

- نظر كل الوراء من مجموعة التغذية بالسلامة/السائل

- والتتحقق من أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها مناسبة للجهاز المعمولية.

- قم بتغيير مجموعات التغذية بمقدار

- A.

- .

- .

- .

- .

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

- لم يتم استخدام هذا الجهاز على النحو المنشود. يمكن تحث

شاف الكبار.

- لا يحتوي على القالات، بما في ذلك DEHP.

- غير منصنوع من الألكوكاين المطاط الطبيعي، لا ينبعض.

- .

- تحذيرات:

- للاستخدام المعياري فقط.

- غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.

- قم بإعداد مجموعة الإدارة المعمولية أو المحققة بمقدار

- ENFit®.

- صل مجموعة الإدار المعمولية أو المحققة بمقدار

- الخاص بمقدار التقنية.

- نظر كل الوراء من مجموعة التغذية بالسلامة/السائل

- والتتحقق من أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها مناسبة للجهاز المعمولية.

- قم بتغيير مجموعات التغذية بمقدار

- A.

- .

- .

- .

- .

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

- لم يتم استخدام هذا الجهاز على النحو المنشود. يمكن تحث

شاف الكبار.

- لا يحتوي على القالات، بما في ذلك DEHP.

- غير منصنوع من الألكوكاين المطاط الطبيعي، لا ينبعض.

- .

- تحذيرات:

- للاستخدام المعياري فقط.

- غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.

- قم بإعداد مجموعة الإدارة المعمولية أو المحققة بمقدار

- ENFit®.

- صل مجموعة الإدار المعمولية أو المحققة بمقدار

- الخاص بمقدار التقنية.

- نظر كل الوراء من مجموعة التغذية بالسلامة/السائل

- والتتحقق من أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها مناسبة للجهاز المعمولية.

- قم بتغيير مجموعات التغذية بمقدار

- A.

- .

- .

- .

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

- لم يتم استخدام هذا الجهاز على النحو المنشود. يمكن تحث

شاف الكبار.

- لا يحتوي على القالات، بما في ذلك DEHP.

- غير منصنوع من الألكوكاين المطاط الطبيعي، لا ينبعض.

- .

- تحذيرات:

- للاستخدام المعياري فقط.

- غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.

- قم بإعداد مجموعة الإدارة المعمولية أو المحققة بمقدار

- ENFit®.

- صل مجموعة الإدار المعمولية أو المحققة بمقدار

- الخاص بمقدار التقنية.

- نظر كل الوراء من مجموعة التغذية بالسلامة/السائل

- والتتحقق من أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها مناسبة للجهاز المعمولية.

- قم بتغيير مجموعات التغذية بمقدار

- A.

- .

- .

- .

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

- لم يتم استخدام هذا الجهاز على النحو المنشود. يمكن تحث

شاف الكبار.

- لا يحتوي على القالات، بما في ذلك DEHP.

- غير منصنوع من الألكوكاين المطاط الطبيعي، لا ينبعض.

- .

- تحذيرات:

- للاستخدام المعياري فقط.

- غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.

- قم بإعداد مجموعة الإدارة المعمولية أو المحققة بمقدار

- ENFit®.

- صل مجموعة الإدار المعمولية أو المحققة بمقدار

- الخاص بمقدار التقنية.

- نظر كل الوراء من مجموعة التغذية بالسلامة/السائل

- والتتحقق من أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها مناسبة للجهاز المعمولية.

- قم بتغيير مجموعات التغذية بمقدار

- A.

- .

- .

- .

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

- لم يتم استخدام هذا الجهاز على النحو المنشود. يمكن تحث

شاف الكبار.

- لا يحتوي على القالات، بما في ذلك DEHP.

- غير منصنوع من الألكوكاين المطاط الطبيعي، لا ينبعض.

- .

- تحذيرات:

- للاستخدام المعياري فقط.

- غير مخصصة للاستعمال عن طريق الوريد.

- قم بإعداد مجموعة الإدارة المعمولية أو المحققة بمقدار

- ENFit®.

- صل مجموعة الإدار المعمولية أو المحققة بمقدار

- الخاص بمقدار التقنية.

- نظر كل الوراء من مجموعة التغذية بالسلامة/السائل

- والتتحقق من أن جميع الأجهزة التي يتم استخدامها مناسبة للجهاز المعمولية.

- قم بتغيير مجموعات التغذية بمقدار

- A.

- .

- .

- .

- إن الأجزاء الصغيرة تتطلب حفظًا متأنًٍا بسبب الاختناق إذا.

